



广州市精翱检测技术有限公司
Guangzhou Jing Ao Detection Technology Co., Ltd.



检 测 报 告

报告编号: JA2025052815

委托单位: 广州新兴金属有限公司电镀车间

项目名称: 广州新兴金属有限公司电镀车间地下水自行监测

检测类型: 委托检测

检测项目: 地下水

报告日期: 2025年6月24日

广州市精翱检测技术有限公司

(检测检测专用章)

检测报告声明


- 一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本公司的采样程序严格按照国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则规定执行。
- 三、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证专用章无效。
- 四、报告无编写人、复核人、审核人和签发人（授权签字人）签字无效。
- 五、报告涂改增删无效。
- 六、未经本公司书面许可，不得部分复制报告（全部复制除外）。
- 七、除非另有说明，本报告检测结果仅对本次检验样品负责。
- 八、如对检测报告有疑问，请在报告收到之日起 7 日内向本公司综合室查询，来函来电请注明委托登记号或报告编号。
- 九、对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。

地址：广州市荔湾区龙溪中路 166 号之十 301

邮编：510378

联系电话（传真）：020-36088280

编写: 李斯琪



复核: 张丽凤



审核: 林荣校



签发: 李敬源



签发人职务: 质量负责人(高工)

签发日期: 2025年6月24日

采样人员: 包天胜、麦培洋

分析人员: 陈嘉慧、钟泳琦、张家城、麦嘉慧、梁绮颖、
郭剑亮、陈伟健、谢文清

一、检测任务

受广州新兴金属有限公司电镀车间委托,对广州新兴金属有限公司电镀车间的地下水进行检测和分析。

二、委托单位概况

单位名称: 广州新兴金属有限公司电镀车间

单位地址: 广州市从化鳌头镇新村村下长三队 160 号

联系人: 利军成

联系电话: 13570483423

三、检测内容

1 地下水检测内容

地下水采样点位、检测项目及检测频次等情况见表 1, 地下水检测点位见图 1

表 1 检测概况一览表

样品类别	采样点位	检测项目	天数	频次
地下水	S2、S3、S4	pH 值、浊度、色度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、氟化物、氯化物、亚硝酸盐 (以 N 计)、硝酸盐 (以 N 计)、硫酸盐、铁、锰、镍、铜、锌、铅、镉、汞、砷	1	1

四、检测结果

1 地下水检测结果

1.1 地下水检测结果见(表2)

表2 地下水检测结果

采样时间	2025-5-28	分析时间	2025-5-28 至 2025-6-7			
检测环境条件	常温、常压	样品状态	正常			
检 测 项 目 及 结 果						
样品编号	S20250528Ae01	S20250528Ae02	S20250528Ae03 (S20250528Ae0 4 为 Ae03 平行)	标准限 值	结果 评价	单位
采样点位 检测项目	S2 (E113°25'54", N23°40'12")	S3 (E113°25'53", N23°40'12")	S4 (E113°25'51", N23°40'13")			
pH 值	6.7	6.7	7.0	≥6.5 且≤ 8.5	达标	无量纲
浊度	76	55	88	≤3	超标	NTU
色度	5	5	5	≤15	达标	度
总硬度	113	196	412	≤450	达标	mg/L
溶解性总固体	322	458	886	≤1000	达标	mg/L
耗氧量	1.4	2.0	2.0	≤3.0	达标	mg/L
氨氮	0.288	0.380	0.300	≤0.50	达标	mg/L
氟化物	0.018	0.020	0.002L	≤0.05	达标	mg/L
阴离子表面活性 剂	0.113	0.142	0.132	≤0.3	达标	mg/L
六价铬	0.004L	0.012	0.004L	≤0.05	达标	mg/L
总铬	0.006	0.015	0.004L	—	—	mg/L
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.36	0.67	0.69	1.8	达标	mg/L
氯化物	129	101	91.1	≤250	达标	mg/L
硝酸盐(以 N 计)	1.88	1.64	2.90	≤20.0	达标	mg/L
亚硝酸盐(以 N 计)	0.273	0.222	0.177	≤1.00	达标	mg/L
硫酸盐	98.8	83.4	12.4	≤250	达标	mg/L

续表2

样品编号	S20250528Ae01	S20250528Ae02	S20250528Ae03 (S20250528Ae04 为 Ae03 平行)	标准限值	结果评价	单位
采样点位 检测项目	S2 (E113°25'54", N23°40'12")	S3 (E113°25'53", N23°40'12")	S4 (E113°25'51", N23°40'13")			
氟化物	0.305	0.394	0.006L	≤1.0	达标	mg/L
铁	0.12	0.15	0.02	≤0.3	达标	mg/L
锰	0.04	0.08	0.07	≤0.10	达标	mg/L
镍	0.007L	0.016	0.016	≤0.02	达标	mg/L
铜	0.04L	0.17	0.09	≤1.00	达标	mg/L
锌	0.057	0.242	0.215	≤1.00	达标	mg/L
铅	1.62×10^{-3}	1.66×10^{-3}	3.18×10^{-3}	≤0.01	达标	mg/L
镉	3.70×10^{-3}	2.36×10^{-3}	4.42×10^{-3}	≤0.005	达标	mg/L
汞	2.2×10^{-4}	1.3×10^{-4}	$4 \times 10^{-5}L$	≤0.001	达标	mg/L
砷	$3 \times 10^{-4}L$	$3 \times 10^{-4}L$	$3 \times 10^{-4}L$	≤0.01	达标	mg/L
执行标准	其中石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 参照执行《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019) 推导值; 其他项目执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) III类标准。					
备注	数据后标注“L”表示检测浓度低于检出限或最低检出浓度。					

2 检测点位布置图

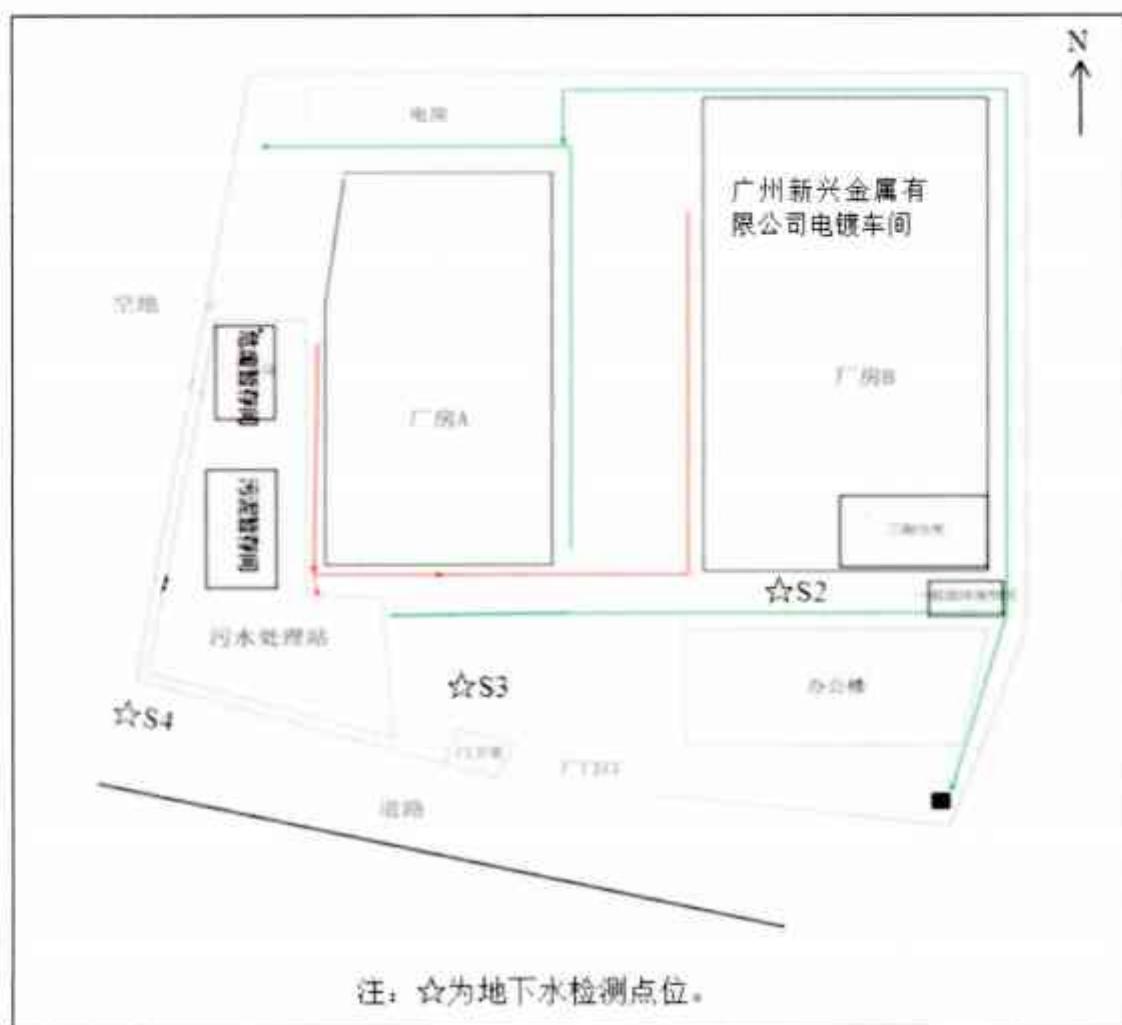


图 1 地下水采样点位

五、检测方法、检出限及使用仪器

1 检测方法、检出限及使用仪器见(表3)

表3 检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限	使用仪器
地下水	pH值	电极法	HJ 1147-2020	—	便携式pH计
	浊度	浊度计法	HJ 1075-2019	0.3 NTU	便携式浊度计
	色度	铂-钴标准比色法	DZ/T 0064.4-2021	5度	—
	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	DZ/T 0064.15-2021	3.0mg/L	—
	溶解性总固体	105°C烘干重量法	DZ/T 0064.9-2021	—	万分之一电子天平
	耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	DZ/T 0064.68-2021	0.4mg/L	—
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计
	氟化物	异烟酸-毗唑啉酮分光光度法	GB/T 5750.5-2023/7.1	0.002mg/L	紫外可见分光光度计
	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2023/13.1	0.050 mg/L	紫外可见分光光度计
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法	DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计
	总铬	二苯碳酰二肼分光光度法	DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L	紫外可见分光光度计
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱法	HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪
	氯化物	离子色谱法	HJ 84-2016	0.007mg/L	离子色谱仪
	硝酸盐(以N计)	离子色谱法	HJ 84-2016	0.004mg/L	离子色谱仪
	亚硝酸盐(以N计)	离子色谱法	HJ 84-2016	0.005mg/L	离子色谱仪
	硫酸盐	离子色谱法	HJ 84-2016	0.018mg/L	离子色谱仪
	氟化物	离子色谱法	HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪
	铁	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.01mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪
	锰	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.01mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪

续表3

样品类别	检测项目	检测方法	方法来源	检出限	使用仪器
地下水	镍	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.007mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪
	铜	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.04mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪
	锌	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	0.009mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪
	铅	无火焰原子吸收分光光度法	DZ/T 0064.21-2021	1.24×10^{-3} mg/L	石墨炉原子吸收分光光度计
	镉	无火焰原子吸收分光光度法	DZ/T 0064.21-2021	1.7×10^{-4} mg/L	石墨炉原子吸收分光光度计
	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计
	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计

****报告结束****